
Technische Information
Technical Information

ELEKTRONIK-
MESS- UND
TONSTUDIOTECHNIK

EMT-FRANZ GMBH

Postfach 1520, D-7630 Lahr
Tel. 07825/512, Telex 754319 franz d
Neue Rufnummer: 07825/1011

STUDIO-TONDOSE
STUDIO PICK-UP CARTRIDGE
EMT TSD 15

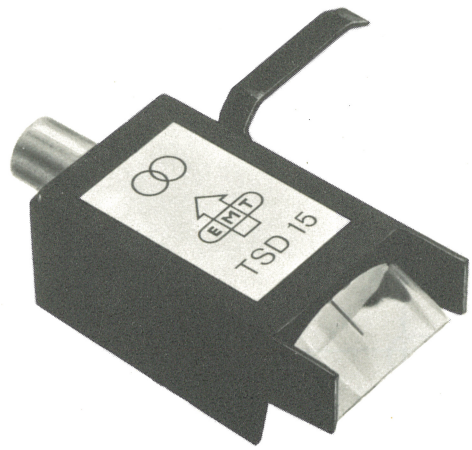

Das Studio-Tonabnehmersystem EMT TSD 15 arbeitet optimal in Verbindung mit dem Studio Tonarm EMT 929.
Zur Pegel- und Impedanz-Anpassung an übliche Hi-Fi-Entzerrerverstärker mit 47 kΩ Eingangswiderstand ist die Verwendung der Studio-Eingangsübertrager 4 150 050 erforderlich.
Umstehende Skizzen erleichtern den Anschluß.


The Studio Pick-up System EMT TSD 15 will produce optimal performance in connection with the Studio Tone arm EMT 929.
To match normal Hi-Fi-Amplifiers with a 47 kΩ input impedance, an additional step-up transformer 4 150 050 is required.
For installation please refer to the drawings on the reverse side.

TIDE-010-075-U · Printed in the Federal Republic of Germany


Tonarm EMT 929:
Tone arm EMT 929:

Montageabstand zwischen Plattenteller-Mittelpunkt und Tonarm-Drehpunkt (Sockel) = 230 mm.

Mounting distance between turntable center and tone arm socket center = 230 mm.

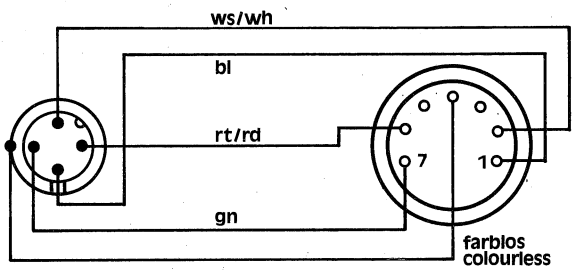

Draufsicht auf Einsteckteile des Tonarmes.
Tone arm connections viewed from front.

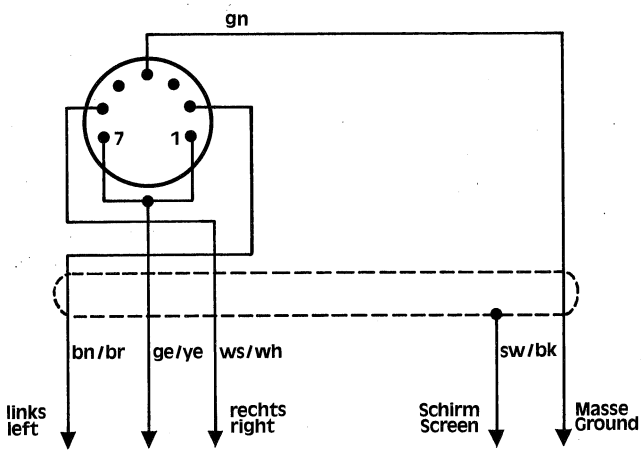


Steckeransicht von Lötseite.
View on wired side of plug.

Tondose TSD 15:
Pick-up TSD 15:


Ansicht auf Zapfen

View on stud

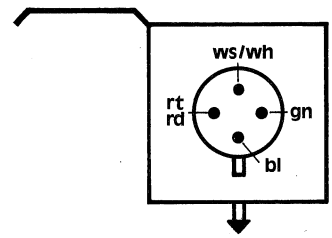

Rechts: rot/grün
Right: red/green
Links: weiß/blau
Left: white/blue
(+/−)

Eingangsübertrager 4 150 050:
Step-up transformer 4 150 050:

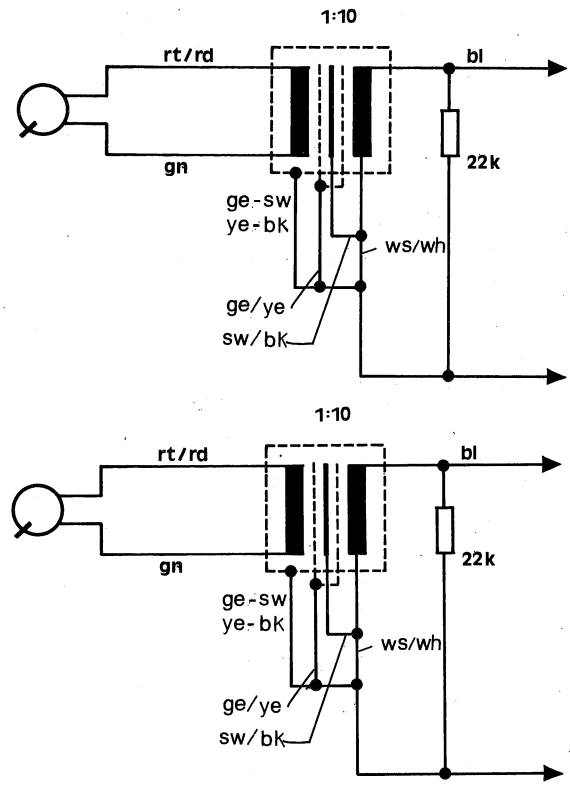

EMT-FRANZ GMBH
Postfach 1520, D-7630 Lahr, Tel. 07825-1011, Telex: 754319